


4

L'Obstacle sur la voie entraine une circulation à contre sens

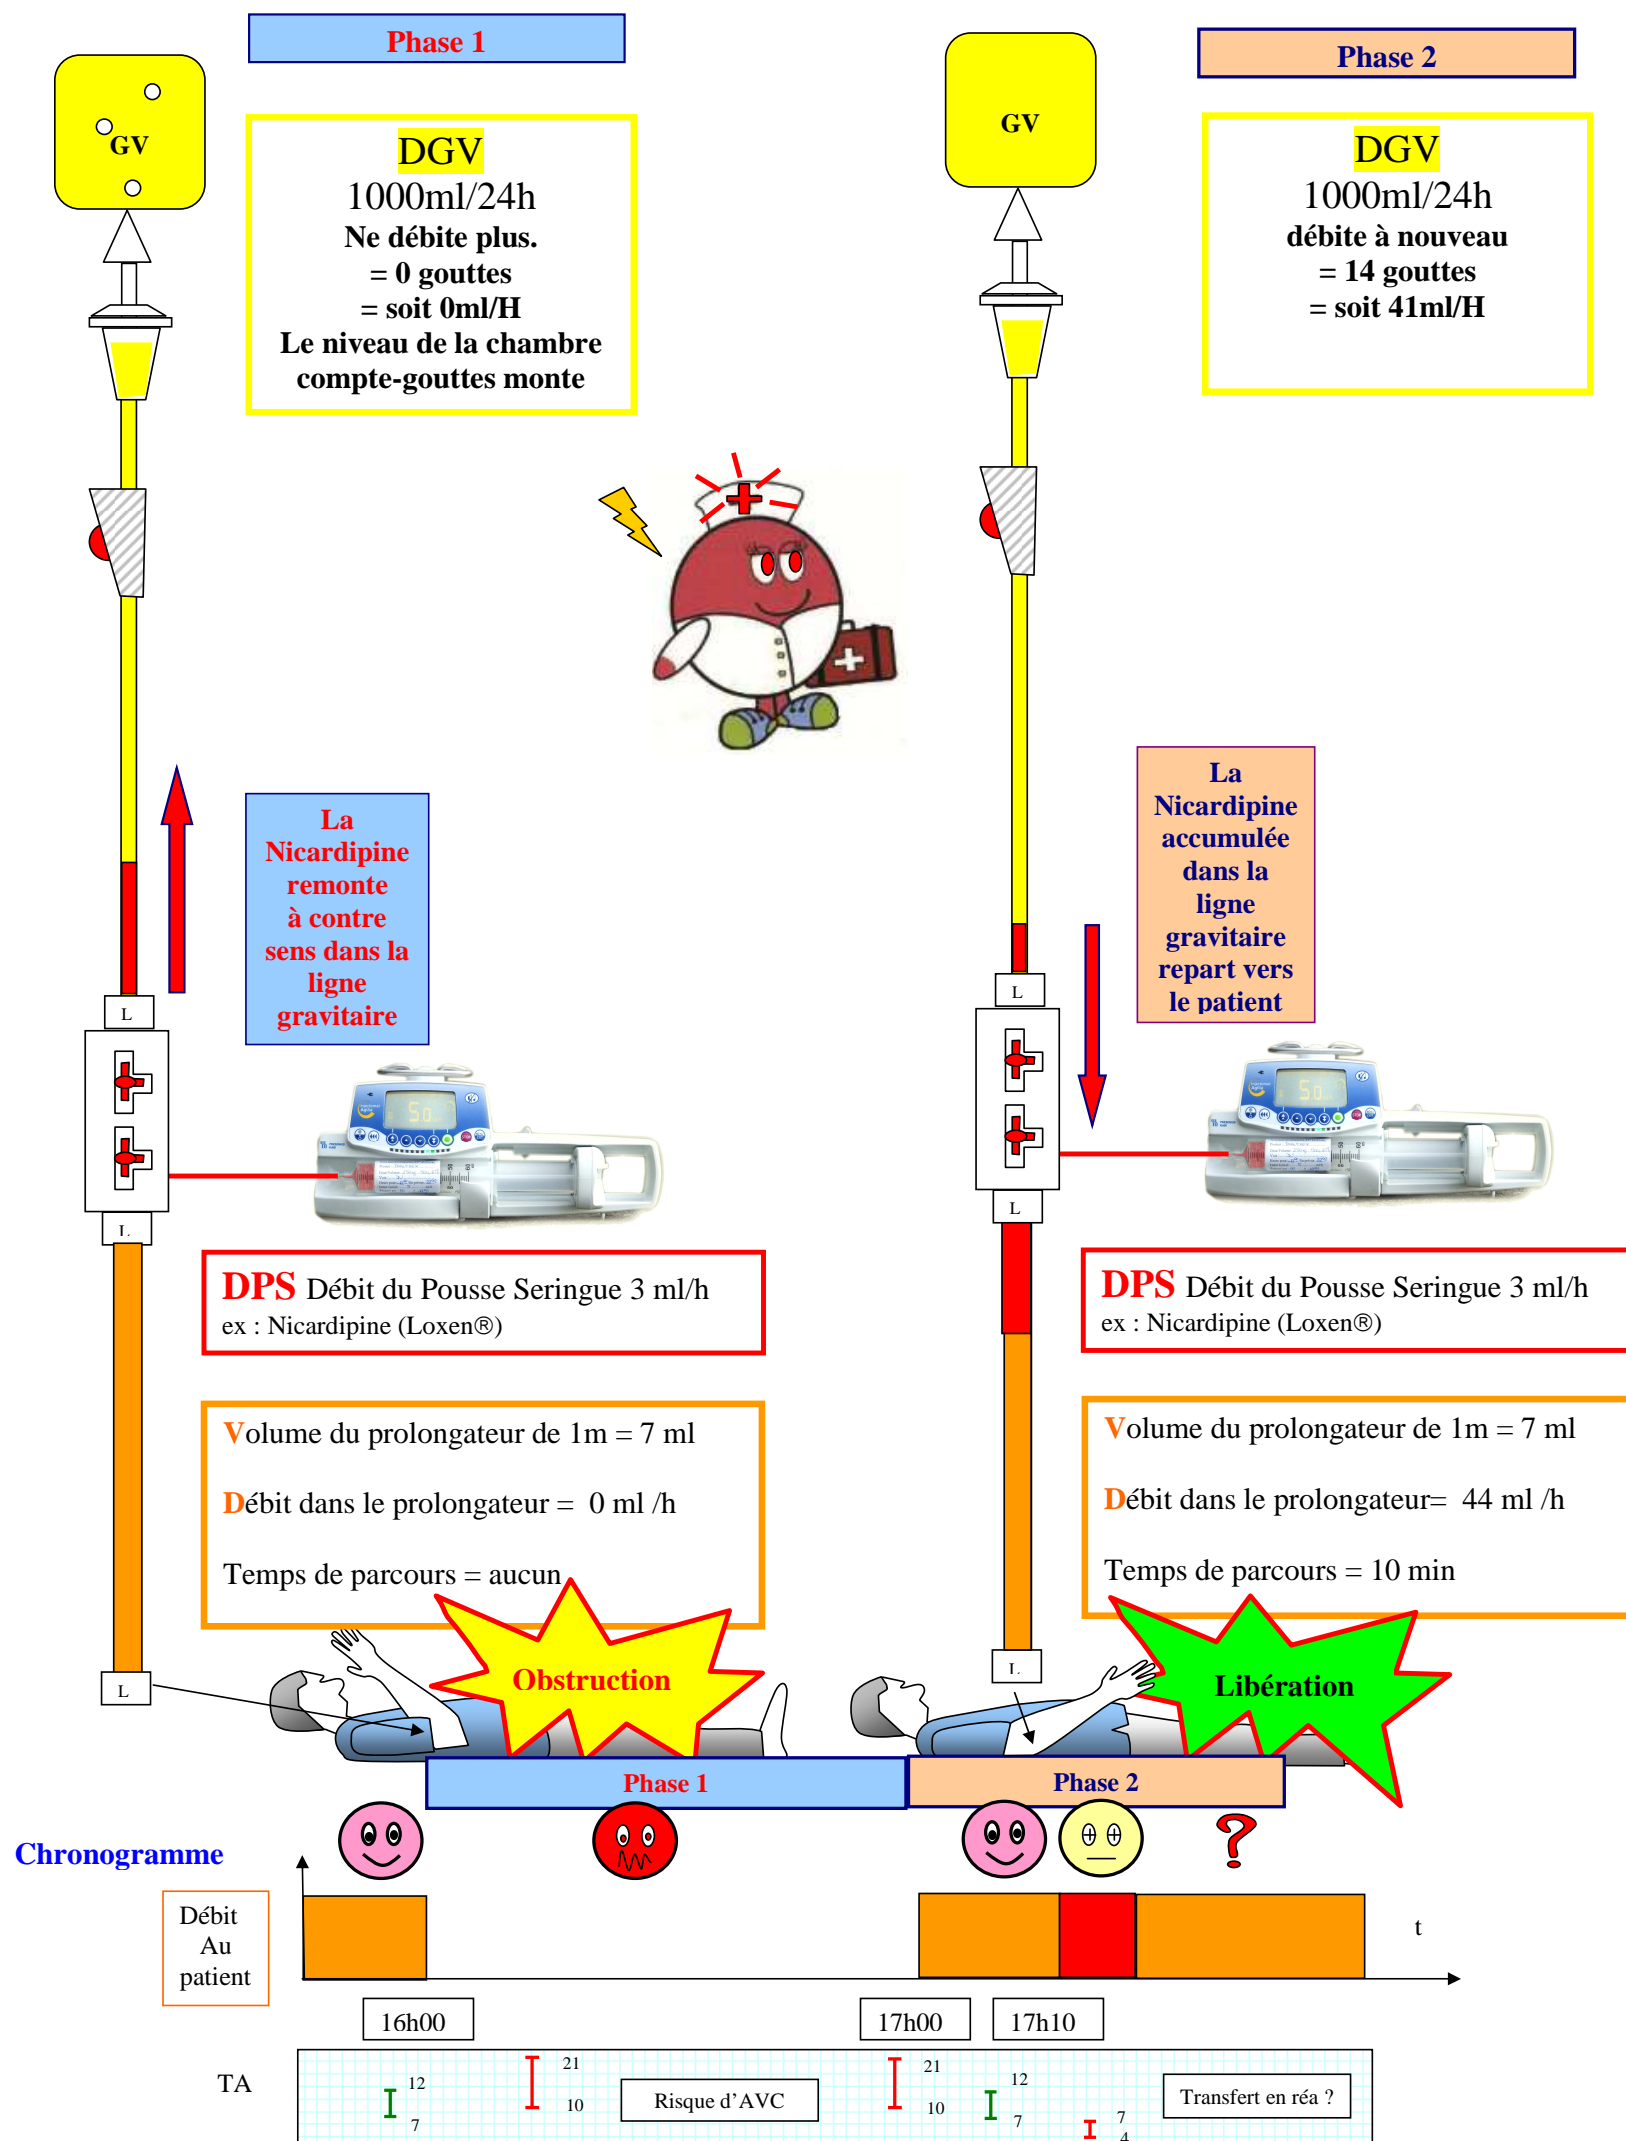

La voie d'abord est **fermée pendant une heure** (phase 1)

1. Le produit dilué n'arrive plus au patient
2. Le principe actif (produit pur) remonte vers la poche à 3 ml /h

La voie d'abord **se libère** (phase 2)

1. Le débit dans le prolongateur se rétablit à 44 ml /h
2. le patient reçoit 7 ml de produit dilué à 44 ml/h
3. puis un bolus de 3 ml de principe actif à un débit de 44 ml/h (soit 3 mg en 4 minutes)
4. puis la perfusion revient à la normale

